**Description of this Thermometer**

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor / measuring tip
- ⑤ Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

• For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible tip are available.

• Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

• Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

• Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

• Protect the device from impact and dropping!

• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

• We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local medical service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part**Turning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①, a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 15 seconds and that the thermometer can now be read. To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 2 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axilla takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
Attention: For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip.


Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from

EN

the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

For professional use: You may apply probe covers (available as accessory). Contact Microlife for further details concerning suitable disinfectants for your thermometer model.

Battery Replacement

When the ▶▼ symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Maximum thermometer
Measurement range: 32.0 °C to 43.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C, 34 °C - 42 °C
± 0.2 °C, 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C

Operating conditions: 10 - 40 °C, 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions: -25 - +60 °C, 15-95 % relative maximum humidity

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)

IP Class: IP67

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers;

ASTM E112, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-1

Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Guarantee

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

We recommend that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

Protect the device from impact and dropping!

Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local medical service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part**Turning on the Thermometer**

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①, a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 15 seconds and that the thermometer can now be read. To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 2 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axilla takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

► In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute!

► In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
Attention: For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip.

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from



Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Type zastosowanych części - BF**Włączanie termometru**

Aby włączyć termometr, wcisnąć przycisk ON/OFF (wl/wyl) ①: krótki sygnał dźwiękowy oznacza, że «termometr jest włączony». Następnie test wyświetlać. Elementy informacyjne powinny być wyświetlane. Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż 32 °C, na wyświetlaczu ② pojawi się «L» i miganie «C». Termometr jest gotów do pomiaru.

Sprawdzenie dzialania

Prawidłowe funkcjonowanie termometru jest sprawdzane automatycznie po każdym jego włączeniu. W przypadku wykrycia awarii (niedokładnego pomiaru) na wyświetlaczu pojawi się «ERR», a dalsze wykonywanie pomiarów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji termometr należy przesłać do serwisu w celu jego sprawdzenia.

Korzystanie z termometru

Wybrany żądaną metodę pomiaru. Podczas wykonywania pomiaru na wyświetlaczu podawana jest aktualna temperatura (miga symbol «C»). Zakonchenie pomiaru zaznacza to, że wzrost temperatury w ciągu 1 sekundy jest mniejszy niż 0,1 °C. W celu przedłużenia czasu pracy baterii należy wyłączyć zasilanie po zakończeniu pomiaru dla pomocej przycisku ON/OFF (wl/wyl) ①. W przewimy wypadku termometr wyłączy się samodzielnie po 10 minutach.

Przeciwchociały wyników

Podczas włączania urządzenia przytrzymaj przycisk ON/OFF (wl/wyl) ① przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol «M» (memory - pamięć). Po kolejnych 2 sekundach znikać wartości temperatury i termometr powróci do normalnego trybu pracy.

Metryka pomiarowa / Basowa temperatura ciała

► Pod paczka (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wytrząsz paczkę suchym ręcznikiem. Umieść czujnik pomiarowy ④ pod paczką, położyć ją na głowicy i zamknij. Wykonaj test.

► Pod rectal (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
Uwaga: W celu zapobiegania perforacji odbytnicy u dzieci (poniżej 3 lat) zalecamy stosowanie innej metody pomiaru lub termometru z elastyczną końcówką.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

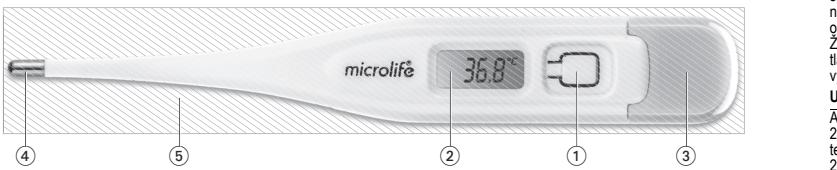
Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

Uwaga: Wykonaj test z jasnymi pojęciami: zanim zaczniesz pomiar, zdejmij wszystkie rzeczy, które mogą wpływać na rezultat.

**Popis teploméru**

- 1 Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
- 2 Displej
- 3 Kryt prostoru pre baterie
- 4 Měřicí snímač / měřicí hrot
- 5 Čisticí a dezinfekční prostor (celý povrch teploméru)

CZ**Výmenná batéria**

Pokud se na displeji objeví symbol (trojúhelník stojící na špičce), je batéria vystavená a je nutno ji vymenit. Pokud chceš bateriu vymenit, sejmějte z teploméru kryt prostoru pre baterie (3). Vložte novou batériu znázku + nahoru. Vždy máte prípravenú náhradnú batériu stejného typu. Batéria zákupit v ibovomom obchode s elektronikou.

Technické špecifikace

Typ:	Maximálny teplomer
Rozsah merenia:	32,0 °C až 43,9 °C Teplota < 32,0 °C: zobrazuje sa symbol «L» (priľah nízka teplota)
	Teplota > 43,9 °C: zobrazuje sa symbol «H» (priľah vysoká teplota)
Presnosť merenia:	± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C a 42,1 - 43,9 °C
Pozovní podmienky:	10 - 40 °C; max. relativná vlhkosť 15-95 %
Skladovacie podminyky:	-25 - 60 °C; max. relativná vlhkosť 15-95 %
Baterie:	LR41 (1,5V) / SR41 (1,55V)
Zivotnosť batérie:	cca. 4500 merení (na použitie nové batérie)
IP trieda:	IP67
Souvisejúci normy:	EN 12470-3, klinické teplomery; ASTM E112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

- Postupujte podle návodu k použitiu. Tento návod obsahuje dôležité informácie o chodze a bezpečnosti tohto prístroja. Pred používaním prístroja si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte jej po dôležitosti.
- Tento prístroj je určený použiť pouze pre mēriť ľudskej telesnej teploty orálnie, rektálne alebo axiálne (v podľaži). Nepoužívajte sa merať teplomer na iných miestach, ako napríklad v uchu, pretože by to mohlo viesť k chybnému výsledku merať a môže to zpôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte tento prístroj, pokud si myslíte, že je poškozený alebo sa na ňom výsmešne nečo nevyplýva.
- Pre osobu hygieny doporučujeme pred prvým použitím prístroja odčítať podľa pokynu na čistenie.
- Vždy je nutné dodať minimálnu dobu merať, dokud sa neozvee pinpit!

Vezmte na vedomie, že rúzna mesta merať môžu vyzádovať poukáčovaný mériť i zo záverečnou signálom, vyz kapitolu „Metódy merenia / Normálna telesná teplota“.

• Z bezpečnostných dôvodov (rizik preforace rektá) musí rektálni merať u deťí mäsiach 3 roky použiť pouze sklenený zdravotnický personál (profesionálni užívateľi). Použitejto prístrojom metódu merať. Na merať rektálne rektálne deťi mäsiach 3 roky sú u dispozícií výrobca v príručke sprievodni.

Nepoužívajte sa merať rektálne až do poslednej s poruchami konečníku. Mužu to prohnutie nebo zhoršiť onemocnenie.

• Dobeť na to, aby prístroj nevyskávali deliť dobeh do poslednej časti súčasne, že mierejte dojek k jejého spôsobu. V prípade, že je prístroj dodávaný s kabelem či hadicou, hrano nebezpečiť uškrenie.

• Prístroj nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických polí, napr. v mobilnom telefónu alebo rádiowych zařízeních. Prístroj používajte ve vzdialenosťi minimálne 3,3 m od zdroja magnetického záření.

• Výrobek nevystavujte pred pády a nárazy!

• Výrobek nevystavujte teplomátom nad 60 °C. Teplomer NEVYVÁREJTE!

• K čisteniu prístroje používajte pouze komerčné dezinfekčné prostriedky uvedené v časti „Čistenie a dezinfekcia“, abyste predeli poskození prístroja.

• Doporučujeme tento prístroj testovať na presnosť každú dva roky alebo po mechanickom nárazu (napr. po páde). Kontaktujte miestny servis Microlife a požiadajte o prevedenie testu.

UPOZORNENIE: Vysledok merať daný týmto prístrojom není diagnostický! Nespeštejte sa pouze na výsledok merať.

Batéria a elektrónické prístroje nemožno likvidovať v souladu s miestnymi platnými predpismi, nikoliv s domácim odpadom.

• Pred použitím tohto výrobku si pečivo prečítajte návod.

SK Priebežné časti typu BF

Zapnutí teploméru

Teplomer zapnite stiskom tlačidla ON/OFF (1), krátku pinpit signálizuje, že je teplomer zapnutý. Prevede sa test displeja. Všechny segmenty, myšli význam.

Pokud je teplomer okolo nižši než 32 °C, na displeji (2) sa zobrazí «L» a bliká «C». Teplomer je pripravený k použitiu.

Funkčná zkouška Správna funkcia teploméru je automaticky testovaná pri každom zapnutí. V prípade zjistenej poruchy (nepresné merať), sa na displeji zobrazí «ERR» a merať nelze previesť. V tom prípade je nutno teplomer vymeniť.

Použití teploméru Vyberte požadovanou metódou merať. Při použití teploméru je neustále aktualizovaný údaj teploty a bílý symbol «C». Pokud zazní zvukový signál 10 krát a symbol «C» prestane blikat, znamená to, že zmeraný nárasť teploty je už nižší než 0,1 °C za 16 sekund a že je možné odcítiť.

Zivotnosť batérie prudkou, pokud teplomer vypne krátkym stiskom tlačidla ON/OFF (1). Pokud tláčikom nestisknete, teplomer sa automaticky vypne približne po 10 minútach.

Uloženie meraťných hodnot Pokud tlačidlo ON/OFF (1) pridržíte pri zapnutí stisknuté déle než 2 sekundy, automaticky sa zoberají nejvýši naposedly zmerané teplota. Současne sa na displeji objeví s symbolom «P». Približne 2 sekundy po uvolnení tláčidla hodnota teploty zmizí a teplomer je pripravený k merať.

Dôležité bezpečnostné pokyny • Postupujte podľa návodu na tohto. Tento návod obsahuje dôležité informácie o prevádzke a bezpečnosti tohto prístroja. Pred používaním prístroja si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho na ďalšie použitie.

• Skústejte prístroj je možné použiť len pre meranie ľudskej telesnej teploty orálnie, rektálne alebo axiálne (v podľaži). Nepoužívajte sa merať na iných miestach, ako napríklad v uchu, pretože by to mohlo viesť k chybnému výsledku merať a môže to spôsobiť zranenie.

• Nepoužívajte tento prístroj, ak si myslíte, že je poškozený alebo sa na ňom výsmešne niečo nevyplýva.

• Kvôli osobnej hygiene odporúčame pred prvým použitím prístroja odčítať podľa pokynu na čistenie.

• Vždy je nutné dodať minimálnu čas merania, ktorá sa neozve približne 5 minút, bez ohľadu na zvukový signál.

V ústich (orálny) / 34,7 - 37,3 °C Odtrepte podľa súčnu ušku. Měřicí senzor (4) umiestnite pod rameno do stredu podpažia tak, aby sa hoty dotyk položky a rameno pacienta priblížte k jeho telu. To zájsť, že vzdúch v miestnosti neovplyvňa meranie. Následne sa v podľa pokynu na čistenie.

UPOZORNENIE: Vysledok merať daný týmto prístrojom nie je diagnostický! Nespeštejte sa pouze na výsledok merať.

Batéria a elektrónické prístroje nemožno likvidovať v souladu s miestnymi platnými predpismi, nikoliv s domácim odpadom.

• Pred použitím tohto výrobku si pečivo prečítajte návod.

SK Priebežné časti typu BF

Zapnutie teploméru

Teplomer zapnite stiskom tláčidla ON/OFF (1); krátku pinpit signálizuje, že je teplomer zapnutý. Prevede sa test displeja. Všechny segmenty, myšli význam.

Pokud je teplomer okolo nižši než 32 °C, na displeji (2) sa objaví «L» a bliká «C». Teplomer je pripravený k použitiu.

Funkčná zkouška Správna funkcia teploméru je automaticky testovaná pri každom zapnutí. V prípade zjistenej poruchy (nepresné merať), sa na displeji zobrazí «ERR» a merať nelze previesť. V tom prípade je nutno teplomer vymeniť.

Pro profesionálni použití: Múžete používať kryty sondy (k dispozicii ako voliteľné pribľažník). Dáľši informácie týkajúce sa vhodných dezinfekčných prostriedkov pre vás model teploméru získate od společnosti Microlife.

CZ**Výmenna batéria**

Pokud se na displeji objeví symbol (trojúhelník stojící na špičke), je batéria vystavená a je nutno ju vymeniť. Pokud chcete bateriu vymenit, sejmějte z teploméru kryt prostoru pre baterie (3). Vložte novou batériu znázku + nahoru. Vždy máte prípravenú náhradnú batériu stejného typu. Batéria zákupit v ibovomom obchode s elektronikou.

Technické špecifikace

Typ:	Maximálny teplomer
Rozsah merenia:	32,0 °C až 43,9 °C Teplota < 32,0 °C: zobrazuje sa symbol «L» (priľah nízka teplota)
	Teplota > 43,9 °C: zobrazuje sa symbol «H» (priľah vysoká teplota)
Presnosť merenia:	± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C a 42,1 - 43,9 °C
Pozovní podminky:	10 - 40 °C; max. relativná vlhkosť 15-95 %
Skladovacie podminyky:	-25 - 60 °C; max. relativná vlhkosť 15-95 %
Baterie:	LR41 (1,5V) / SR41 (1,55V)
Zivotnosť batérie:	cca. 4500 merení (na použitie nové baterie)
IP trieda:	IP67
Souvisejúci normy:	EN 12470-3, klinické teplomery; ASTM E112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

- Postupujte podle návodu k použitiu. Tento návod obsahuje dôležité informácie o chodze a bezpečnosti tohto prístroja. Pred používaním prístroja si dôkladne prečítajte tento návod a nechovajte ho pre dôležitosť.
- Tento prístroj je určený použiť pouze pre merať ľudskej telesnej teploty (axiálne, rektálne alebo orálnie). Nepoužívajte sa merať na iných miestach, ako napríklad v uchu, pretože by to mohlo viesť k chybnému výsledku merať a môže to zpôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte tento prístroj, pokud si myslíte, že je poškozený alebo sa na ňom výsmešne nečo nevyplýva.
- Pre osobu hygieny doporučujeme pred prvým použitím prístroja odčítať podľa pokynu na čistenie.
- Vždy je nutné dodať minimálnu dobu merať, dokud sa neozvee pinpit!

Vezmte na vedomie, že rúzna mesta merať môžu vyzádovať poukáčovaný mériť i zo záverečnou signálom, vyz kapitolu „Metódy merenia / Normálna telesná teplota“.

• Z bezpečnostných dôvodov (rizik preforace rektá) musí rektálni merať u deťí mäsiach 3 roky použiť pouze sklenený zdravotnický personál (profesionálni užívateľi). Použitejto prístrojom metódu merať. Na merať rektálne rektálne deťi mäsiach 3 roky sú u dispozícií výrobca v príručke sprievodni.

Nepoužívajte sa merať rektálne až do 60 °C. Teplomer NEVYVÁREJTE!

• K čisteniu prístroje používajte pouze komerčné dezinfekčné prostriedky uvedené v časti „Čistenie a dezinfekcia“, aby ste predeli poskození prístroja.

• Doporučujeme tento prístroj testovať na presnosť každú dva roky alebo po mechanickom nárazu (napr. po páde). Kontaktujte miestny servis Microlife a požiadajte o prevedenie testu.

UPOZORNENIE: Vysledok merať daný týmto prístrojom není diagnostický! Nespeštejte sa pouze na výsledok merať.

Batéria a elektrónické prístroje nemožno likvidovať v souladu s miestnymi platnými predpismi, nikoliv s domácim odpadom.

• Pred použitím tohto výrobku si pečivo prečítajte návod.

SK Priebežné časti typu BF

Zapnutí teploméru

Teplomer zapnite stiskom tláčidla ON/OFF (1). Krátku pinpit signálizuje, že je teplomer zapnutý. Prevede sa test displeja. Všechny segmenty, myšli význam.

Pokud je teplomer okolo nižši než 32 °C, na displeji (2) sa zobrazí «L» a bliká «C». Teplomer je pripravený k použitiu.

Funkčná zkouška Sprá